



Erstellt am: 07.08.2013


Erstellt von: MHe

DSfG-Mittelwertarchive




Std-MW-Archive: AG01 & AG05 & AG19 (1/4)

- Gerätestart
- Automatische Kalibrierung
- Fehler kommt / Fehler geht über Stundenwechsel
- Fehler kommt / Fehler geht innerhalb einer Stunde

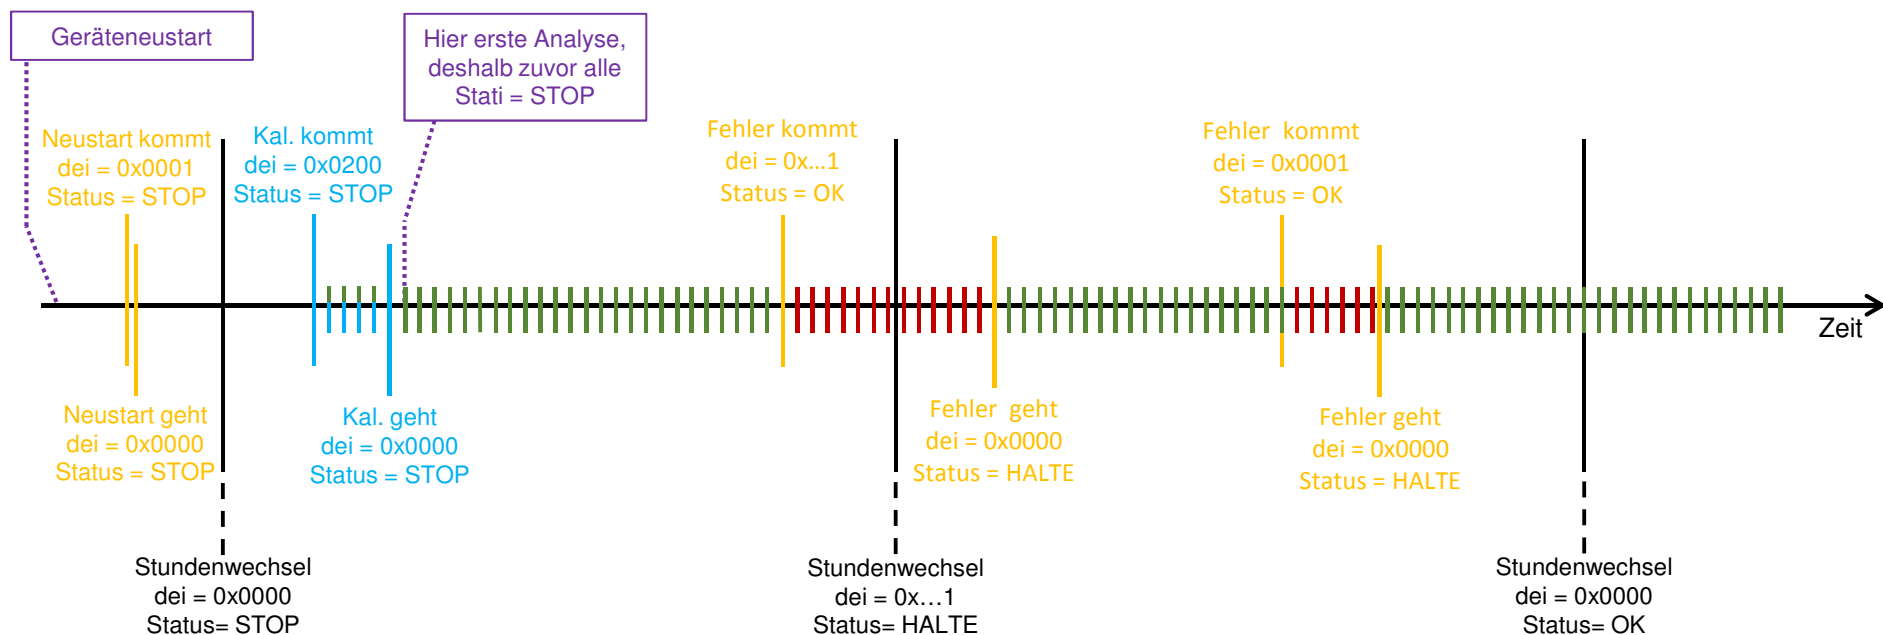


Std-MW-Archive: AG01 & AG05 & AG19 (2/4)

- Fehlerhafte Kalibrierung innerhalb einer Stunde

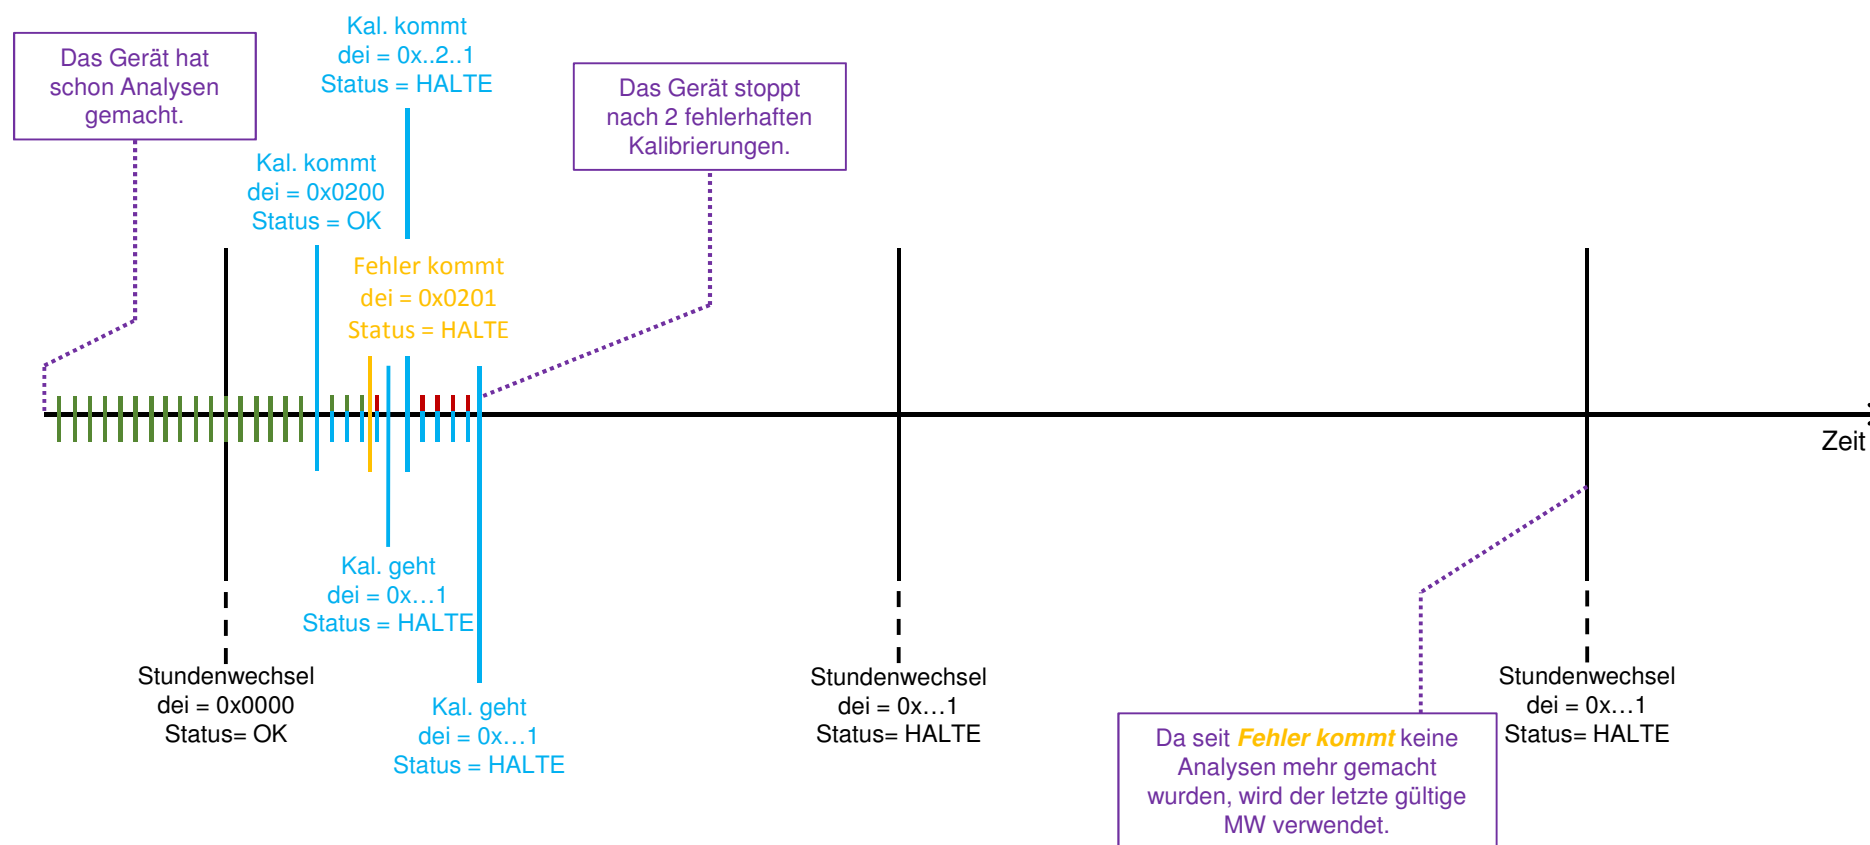


Std-MW-Archive: AG01 & AG05 & AG19 (3/4)

- Kalibrierung über Stundenwechsel

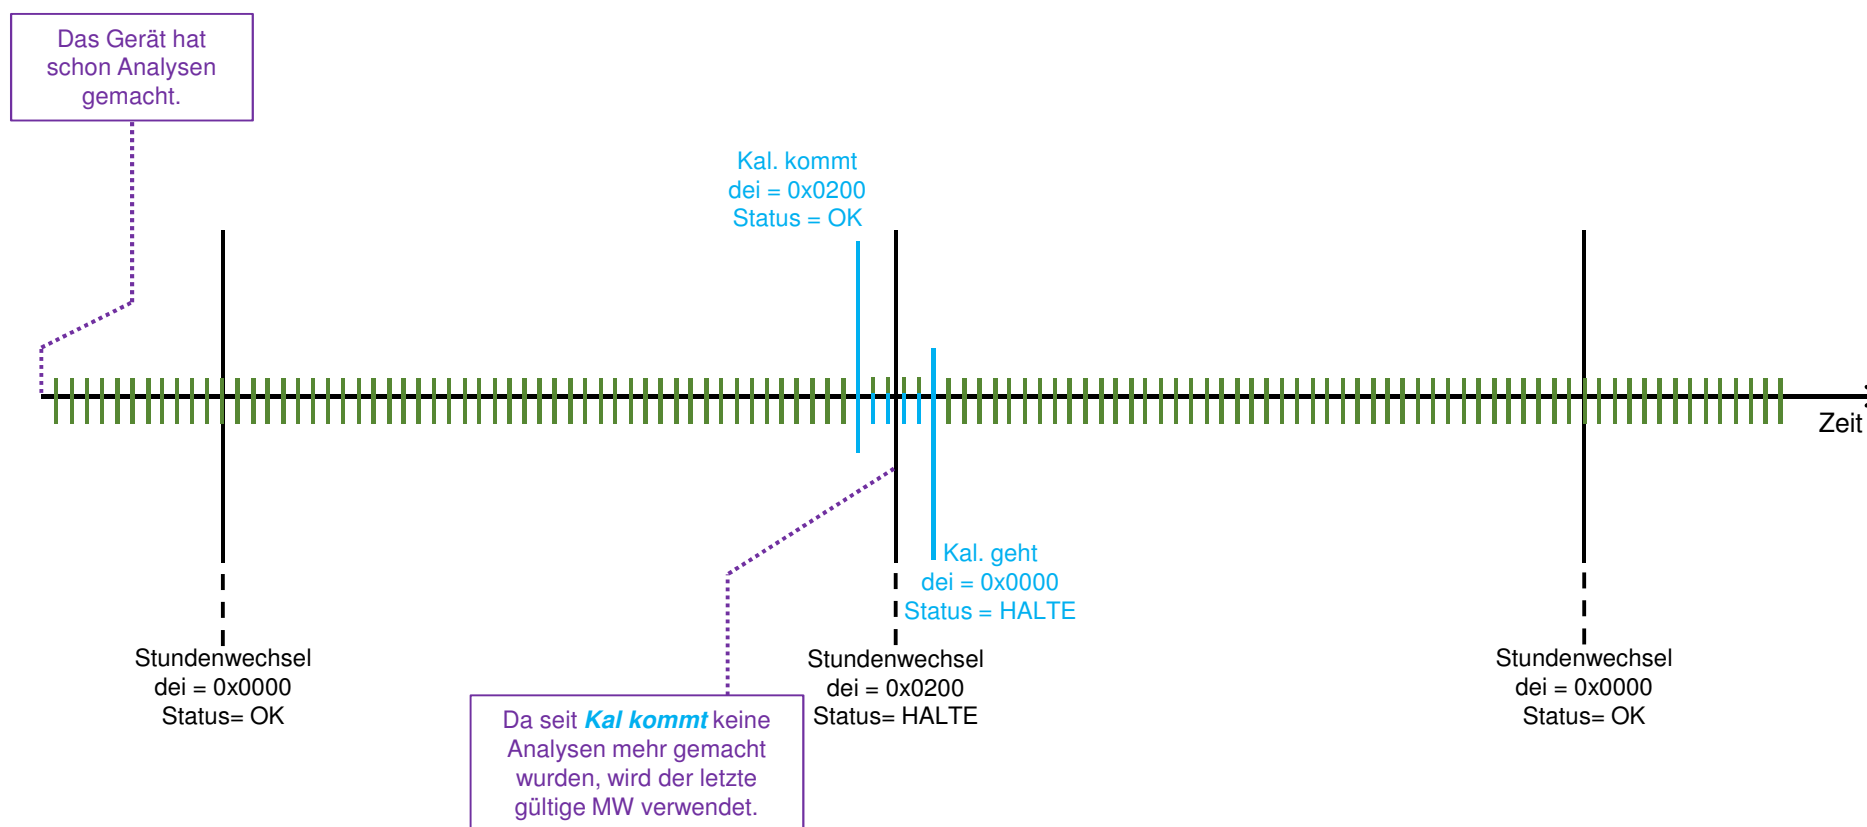

Std-MW-Archive: AG01 & AG05 & AG19 (4/4)

- Normaler Betrieb

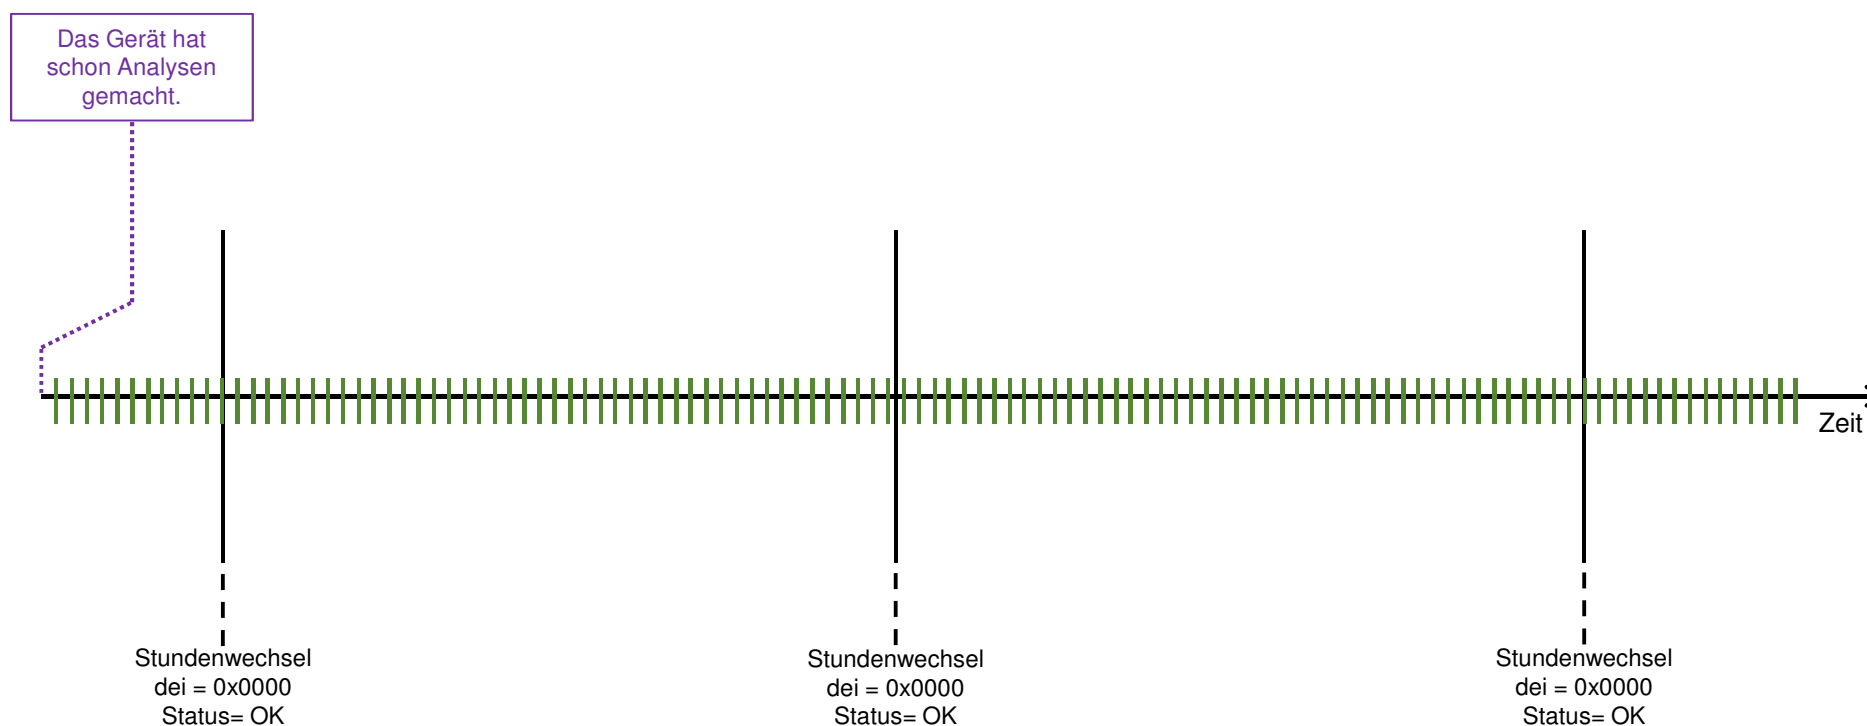

Hinweis

Die anderen DSfG-Mittelwertarchive weisen das selbe Verhalten auf:

- Tagesmittelwerte: AG07
- Monatsmittelwerte: AG09
- 15min-Mittelwerte: AG15